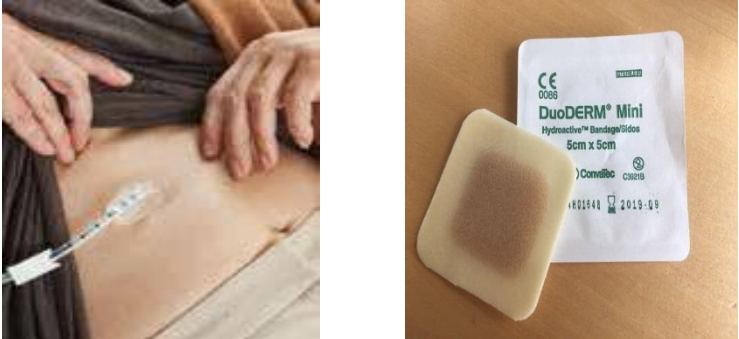
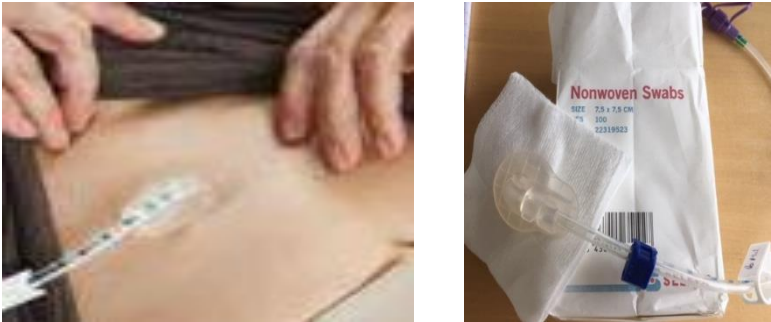


## Guide til hudpleje til patienter med PEG sonder

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Huden:</b> Indstikssted ved nyanlagt PEG pladesonde skal holdes tørt og gives ro til ophealing.</p> <p><b>Hudpleje:</b> "Duoderm mini" anlægges på A-op. Forbindingen tilses dagligt ift. observation af infektionstegn. Forbindingen skiftes altid ved gennemsvining. Forbindingen kan fjernes efter 48 timer, men hvis den tør kan den bibeholdes op til 5 dage. Afstand mellem hud og PEG pladen skal være 2 mm. Sonden trækkes "tot", mens patienten <u>ligger ned</u>.</p> |    |
| <p><b>Ved fjernelse af forbindingen "Duoderm mini"</b></p> <p><b>Huden:</b> Normal hud, ingen rødme eller sivning fra stoma</p> <p><b>Hudpleje:</b> For at beskytte huden lægges "Nonwoven swaps" mellem plade og huden. Daglig afvaskning gerne i brusebad. Huden lufttørres efter badet.</p>                                                                                                                                                                                        |   |
| <p><b>Huden:</b> Ved begyndende irritation af hud under pladen ved PEG sonden.</p> <p><b>Hudpleje:</b> "Nonwoven Swaps" (1 lags) kan lægges mellem plade og hud. Afstand 2 mm. Sonden trækkes "tot", mens patienten <u>ligger ned</u>. "Nonwoven swaps" skiftes hyppigt og altid ved gennemsvining. Vigtigt at infektionssted ved stoma holdes tørt. Daglig afvaskning gerne i brusebad. Huden lufttørres efter badet.</p>                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Huden:</b> Lidt rødme og irriteret hud svarende til kanten af PEG pladen.</p> <p><b>Hudpleje:</b><br/>         Afstand 2 mm mellem plade og hud. Sonden trækkes "tot", når patienten <u>ligger ned</u>.<br/>         Daglig afvaskning. Det røde område smøres med</p> <p><b>1 valg:</b> Mildison lipid 1% creme<br/>         Aftager rødmen ikke vælges</p> <p><b>2 valg:</b> Betnovat salve<br/>         (Betnovatsalve kræver udtrapning). Benyt et tyndt lag creme /salve.<br/>         Forbinding "Mepilex lite" påsættes mellem plade og stoma. Skiftes ved gennemsvivning.</p> | <div data-bbox="657 297 1040 719" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1139 302 1474 719" data-label="Image"> </div> <p>Mildison/Betnovat bestilles via sygehusapoteket</p> |
| <p><b>Huden:</b> Voldsom rødme svarende til hele PEG pladen. Huden kan være tør evt. med hvide belægninger</p> <p><b>Hudpleje:</b><br/>         Afstand 2 mm mellem plade og hud. Sonden trækkes "tot".<br/>         Daglig afvaskning. Det røde område smøres med Betnovat salve.<br/>         Aftager rødmen ikke kan det være svampeinfektion<br/>         Svampebehandling: Betnovat<br/>         Chinoform (kræver lægeordination)<br/>         Huden aflastes med "Mepilex lite".</p>                                                                                                 | <div data-bbox="643 871 1090 1267" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1117 875 1474 1267" data-label="Image"> </div>                                                      |
| <p><b>Huden:</b> Sivning fra stoma, huden er fugtig og rød pga. sivning.</p> <p><b>Hudpleje:</b><br/>         Undersøg om PEG sonden sidder korrekt. Fikser pladen med blå sikkerhedsklemme.<br/>         Ved fortsat sivning kan A-kir sygeplejersker kontaktes (alle hverdage 97661101).<br/>         Absorberende forbinding lægges ovenpå pladen, skiftes x fl dagligt ved gennemsvivning.</p>                                                                                                                                                                                          | <div data-bbox="694 1393 1069 1751" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1086 1402 1449 1751" data-label="Image"> </div>                                                    |

Oktober 2018 :Kirurgisk sygeplejerske i A-ambulatorium Ingeborg Stausholm Binderup, Sårsygeplejerske Camilla Leerskov  
 Sørensen, Ernæringsteamet i stråleterapien og Udviklingskoordinator for Ernæring Lotte Boa Skadhauge